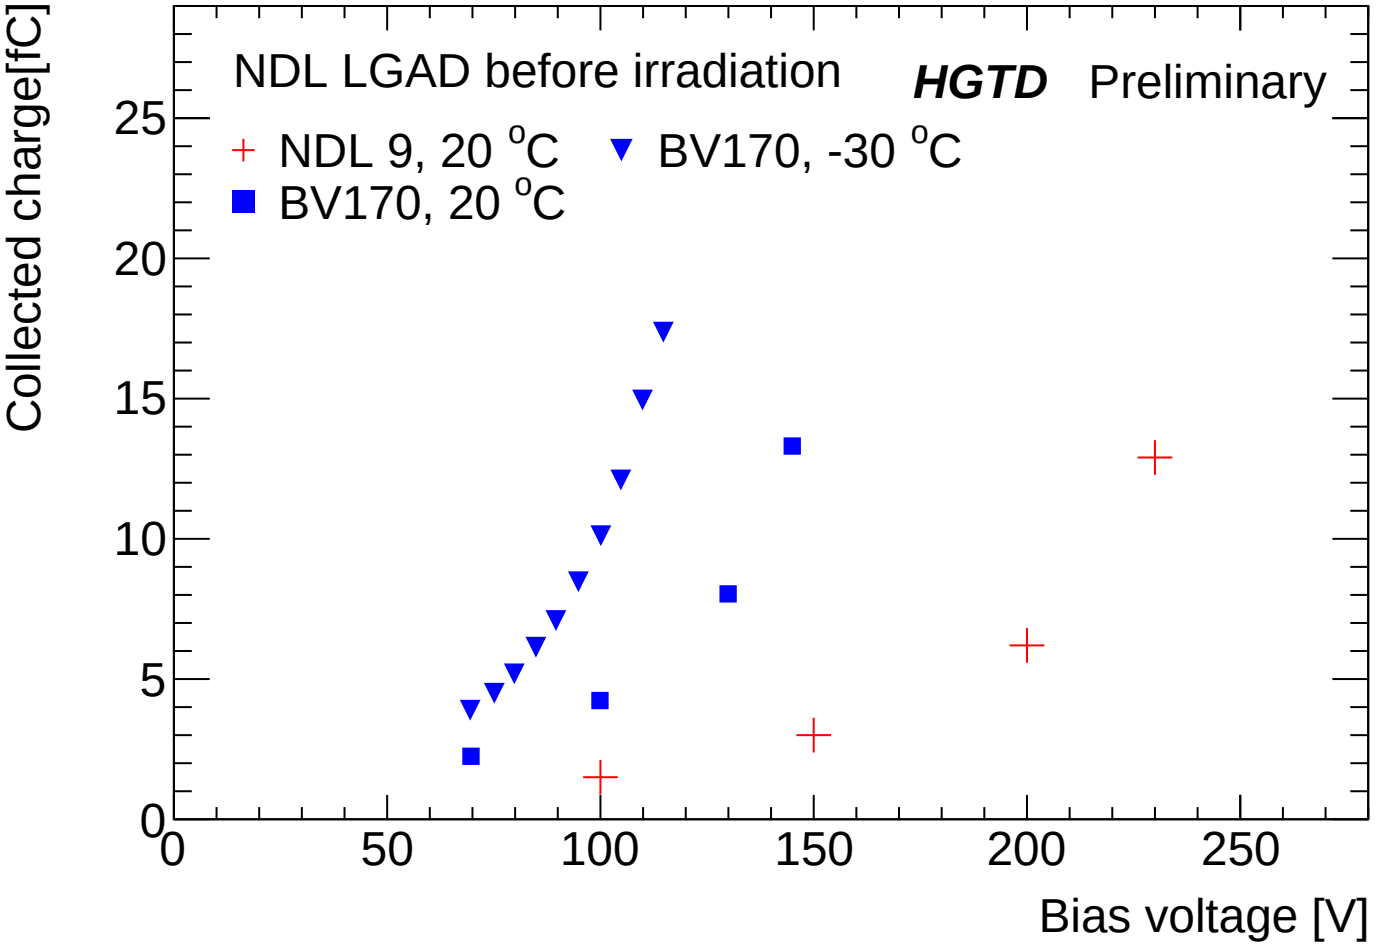
NDL LGAD before irradiation
HGTD Preliminary
NDL 9, 20 °C
BV170, -30 °C
BV170, 20 °C
Collected charge[fC]
Bias voltage [V]
0
5
10
15
20
25
0
50
100
150
200
250